

宁波埃美柯水表有限公司

检测报告

TEST REPORT

证书编号: AM170912-2




计量器具名称 089 旋翼式立式湿式热水表

型号 / 规格 LXSLR-15E~25E

制造单位 宁波埃美柯水表有限公司

检定结论 合格

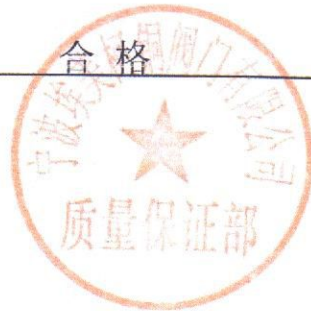

地址: 宁波骆驼通和东路 68 号

邮编: 315202

检定依据：GB/T778-2007/ISO4064：2005

《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》

JJG162-2009 《冷水水表》

检定结果

| 项 目 | 内 容 | | 结 论 |
|------|-----------------|------------------------|-----|
| 外观检查 | 标志齐全、正确，封印完好、完整 | | 合 格 |
| 过载流量 | LXSLR-15E | 3.00m ³ /h | 合 格 |
| | LXSLR-20E | 5.00m ³ /h | |
| | LXSLR-25E | 7.00m ³ /h | |
| 常用流量 | LXSLR-15E | 1.50m ³ /h | 合 格 |
| | LXSLR-20E | 2.50m ³ /h | |
| | LXSLR-25E | 3.50m ³ /h | |
| 分界流量 | LXSLR-15E | 0.12m ³ /h | 合 格 |
| | LXSLR-20E | 0.2m ³ /h | |
| | LXSLR-25E | 0.28m ³ /h | |
| 最小流量 | LXSLR-15E | 0.03 m ³ /h | 合 格 |
| | LXSLR-20E | 0.05m ³ /h | |
| | LXSLR-25E | 0.07m ³ /h | |
| 密封检查 | 1.6MPa / 1Min | | 合 格 |
| 压力损失 | Δ p63 | | 合 格 |
| 试验结论 | 合 格 | | |

检定员：

检 7

核验员：

检 11

日期：

2017-04-12

